


DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÇUBUKLU DIŞÇAP MİKROMETRELERİ

ÖZELLİKLER


- MANDAL KİLİTLİ
- KİLİTLEME VİDASI
- KARBÜR UÇLU ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
- STANDART ÇUBUKLARI İÇERİR
- DİJİTAL MODELLER İÇİN İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ
- PARALELLİK 75 mm' YE KADAR 0,002 mm'DİR
- LR44 PİL
- KALİBRASYON SERTİFİKASI

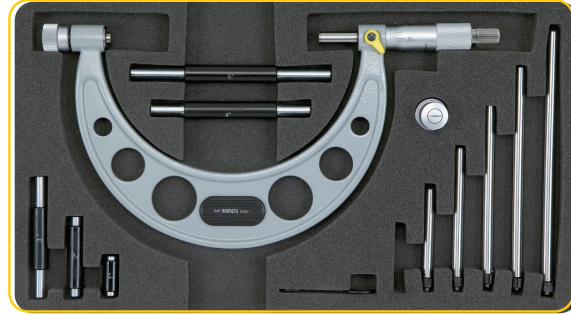

MEKANİK MODEL
ÖLÇEK : 0,01mm

KOD	KAPASİTE	HASSASİYET
AS-111060	0-150 mm	±0,006 mm
AS-111120	150-300 mm	±0,008 mm
AS-111160	300-400 mm	±0,011 mm
AS-111200	400-500 mm	±0,013 mm
AS-111240	500-600 mm	±0,015 mm
AS-111280	600-700 mm	±0,016 mm
AS-111320	700-800 mm	±0,018 mm
AS-111360	800-900 mm	±0,020 mm
AS-111400	900-1000 mm	±0,020 mm

TEKNİK BİLGİLER

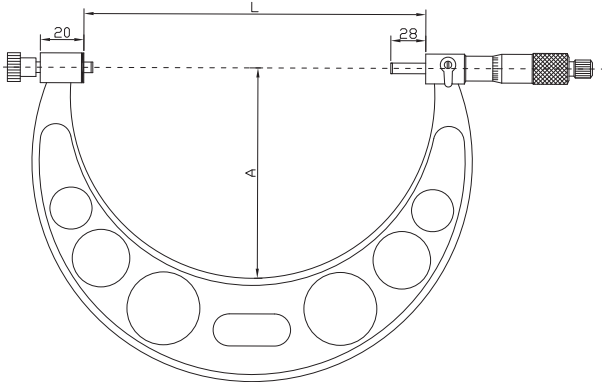

KAPASİTE	A (mm)	L (mm)
0-150 mm	82	158
150-300 mm	165	308
300-400 mm	224	409
400-500 mm	275	509
500-600 mm	321	609
600-700 mm	371	709
700-800 mm	426	809
800-900 mm	476	909
900-1000 mm	576	1009

ASIMETO KALİBRASYON LABORATUARI

Tüm ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin kalite ve kalibrasyon doğruluğu ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında hassas incelemelerle yapılmaktadır.

İncelemeler sırasında tüm hassas ölçü aletlerinin ASIMETO tarafından oluşturulan dizayn ve Dünya çapında standartlarla belirlenen toleranslara uygunluğu %100 olarak kontrol edilir.



Yalnızca Dünya'nın önde gelen firmaları tarafından üretilen son teknoloji kalibrasyon ekipmanları kullanılarak ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin ölçüm hassasiyeti garanti altına alınır.

ASIMETO Kalibrasyon Laboratuvarındaki kalibrasyon ekipmanları hedef marketin ihtiyacına göre DIN, ASME, JJG gibi Uluslararası normların tamamına uyum gösterecek yazılımlarla donatılmıştır.

Tüm bu sayılanlara ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında çalışanların uzmanlık, özveri ve çalışkanlıkları da eklendiğinde ihtiyacınızı karşılayacak hassasiyetteki ölçü aletine ödediğiniz her kuruşun karşılığını tamı tamına alacak şekilde sahip olduğunuza emin olabilirsiniz.

ASIMETO

Calibration Lab

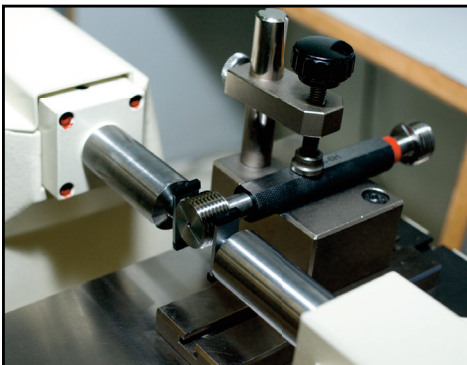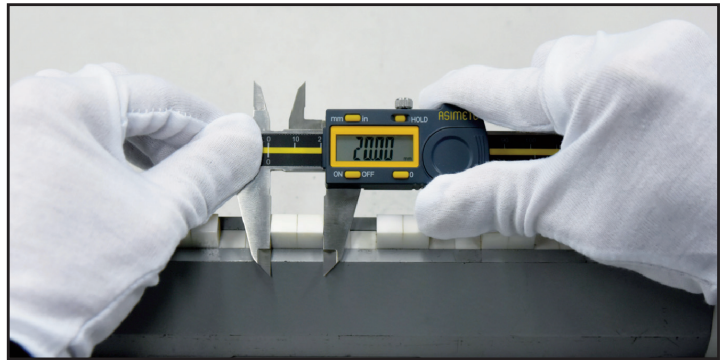

2 Ürün Açıklaması

Kalibrasyon Sertifikası

ASIMETO
Calibration Lab

Certificate No G30001
Part Number 307-06-0
Serial Number GS102042
Standard Name ASME B89.1.14
Tool 0-150mm/0-6"
Range 0.01mm/0.0005"
Resolution Digital Calipers

Function Inspection Passed Visual Inspection Passed

Outside Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
1	0.0000	±0.001"	0.0000	
2	1.0000"	±0.001"	-0.0010	
3	3.0000"	±0.001"	-0.0010	
4	4.5000"	±0.001"	-0.0015	
5	6.0000"	±0.001"	-0.0015	

Inside Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
6	0.2000"	±0.001"	0.0010	
7	1.0000"	±0.001"	0.0010	

Depth Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
8	0.0000	±0.001"	0.0000	

Master information

Depth set	258254	NIST-192837	Due Date
Gauge Block Set	258254	NIST-95837	2013-8-1
Setting Rings	258254	NIST-455837	2013-8-1

Uncertainty 6 µm +10⁻⁶×L Temperature 20 °C ±0.5°C Humidity 50 % ±15%

Attach invoice for proof of purchase date

* Check mark indicates within tolerance

Calibrator

Approved By

Asimeto (Guangzhou) Inc. Calibration Lab

402 Building B, Yushu Industrial Zone, Lubang District, Guangzhou, China;

Tel: 020-82019119 Fax: 020-822261




1 Ölçüm Noktası
& Sonuç

3 Eğilim


4 Takip No.

Bilgi Çıkışlı Ölçü Aletleri

ABS Dijital Kumpas

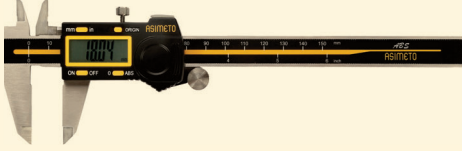

Derinlik Kumpası

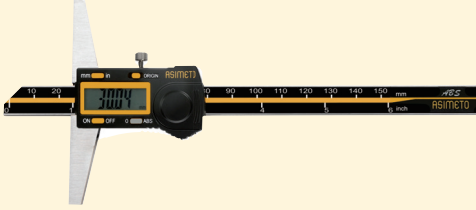

Dijital Mikrometre



Dijital Komparatör Saati



Sanal klavye verileri
toplar ve doğrudan
standart Microsoft
yazılımlarına iletir.
(Excel, Access)



Ölçüm Raporu

	A	B	C	D	E
1		A1	A2	A3	
2	1	10.02	15.53	20.44	
3	2	10.04	15.53	20.46	
4	3	10.01	15.52	20.44	
5	4	10.01	15.53	20.45	
6	5	10.02	15.54	20.46	
7					
8					
9	Average	10.02	15.53	20.45	

BİLGİ ÇIKIŞ KABLOLARI 900 SERİSİ

	UYGUN OLDUĞU ÜRÜN	GİRİŞ TİPİ	FORMAT	UYGUN OLDUĞU ÜRÜN	KOD NO.
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	USB	Dot Data Format	307-XX-2 ; 307-XX-3 105-XX-4 ; 105-XX-5 315-XX-6 ; 315-XX-8	900-05-4
			Comma Data Format		900-05-5
	IP65 Dijital Komparatör Saati	USB	Dot Data Format	407-XX-2 ; 407-XX-3 407-XX-4 ; 407-XX-5	900-07-0
			Comma Data Format		900-07-1
	Dijital Komparatör Saati	USB	Dot Data Format	405-95-X ; 405-01-X 405-02-X ; 405-04-X	900-20-0
	Dijital Mikrometre	USB	Dot Data Format	Özel Dijital Mikrometre	900-10-0
	Dijital Mikrometre	USB	Dot Data Format	Özel Dijital Mikrometre	900-10-2
	Wireless Tip için Ayak Kontrol Butonu				900-90-1

KABLOSUZ BİLGİ ÇIKIŞ TİPLERİ 901 SERİSİ

	KULLANILDIĞI ÜRÜN TİPİ	FONKSİYON	FREKANS	KOD NO.
	IP65 Dijital Komparatör Saati	Transmitter	2.4G	901-00-2
	IP65 Dijital Komparatör Saati ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Receiver	2.4G	901-00-3
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Transmitter	2.4G	901-00-4
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Transmitter with Footswitch Interface	2.4G	901-00-6
	IP65 Dijital Komparatör Saati	Transmitter with Footswitch Interface	2.4G	901-00-7

