

MEKANİK SİLİNDİR KOMPARATÖRÜ

ÖZELLİKLER

- SABİT ÖLÇÜM KISIMLARI ÇELİKTİR
- HAREKETLİ PROP UCU KARBÜR KÜREDİR
- ÖLÇEK 0,01 mm'DİR
- KALİBRASYON SERTİFİKASI



6-10 mm




10-18 mm



18-35 mm



35.... mm



AS-484220

KOD	KAPASİTE	SAAT	UÇ SAYISI	PUL SAYISI	PROP DERİNLİĞİ
AS-484110	6-10 mm	3 mmx0,01 mm	9 parça		40 mm
AS-484120	10-18 mm	3 mmx0,01 mm	9 parça	1 parça	100 mm
AS-484210	18-35 mm	3 mmx0,01 mm	9 parça	2 parça	150 mm
AS-484220	35-50 mm	3 mmx0,01 mm	4 parça	4 parça	150 mm
AS-484310	50-160 mm	3 mmx0,01 mm	12 parça	4 parça	150 mm
AS-484320	160-250 mm	3 mmx0,01 mm	5 parça	5 parça	400 mm
AS-484330	250-400 mm	3 mmx0,01 mm	5 parça	5 parça	400 mm
AS-484340	400-600 mm	3 mmx0,01 mm	5 parça	5 parça	400 mm

KOD	KAPASİTE	ÖLÇEK	HASSASİYET	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)
AS-484110	6-10 mm	0,01 mm	±0,015 mm	48	86	68	4,5
AS-484120	10-18 mm	0,01 mm	±0,015 mm	96	86	68	6
AS-484210	18-35 mm	0,01 mm	±0,020 mm	150	100	80	9
AS-484220	35-50 mm	0,01 mm	±0,020 mm	150	100	80	12,8
AS-484310	50-160 mm	0,01 mm	±0,025 mm	150	100	80	12,8
AS-484320	160-250 mm	0,01 mm	±0,025 mm	408	100	80	14,5
AS-484330	250-400 mm	0,01 mm	±0,025 mm	408	100	80	14,5
AS-484340	400-600 mm	0,01 mm	±0,025 mm	408	100	80	14,5

ASIMETO KALİBRASYON LABORATUARI

Tüm ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin kalite ve kalibrasyon doğruluğu ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında hassas incelemelerle yapılmaktadır.

İncelemeler sırasında tüm hassas ölçü aletlerinin ASIMETO tarafından oluşturulan dizayn ve Dünya çapında standartlarla belirlenen toleranslara uygunluğu %100 olarak kontrol edilir.



Yalnızca Dünya'nın önde gelen firmaları tarafından üretilen son teknoloji kalibrasyon ekipmanları kullanılarak ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin ölçüm hassasiyeti garanti altına alınır.

ASIMETO Kalibrasyon Laboratuvarındaki kalibrasyon ekipmanları hedef marketin ihtiyacına göre DIN, ASME, JJG gibi Uluslararası normların tamamına uyum gösterecek yazılımlarla donatılmıştır.

Tüm bu sayılanlara ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında çalışanların uzmanlık, özveri ve çalışkanlıkları da eklendiğinde ihtiyacınızı karşılayacak hassasiyetteki ölçü aletine ödediğiniz her kuruşun karşılığını tamı tamına alacak şekilde sahip olduğunuza emin olabilirsiniz.

ASIMETO

Calibration Lab

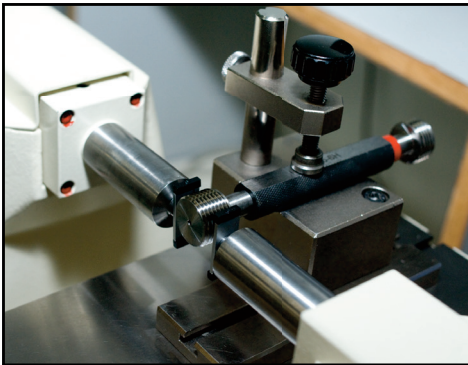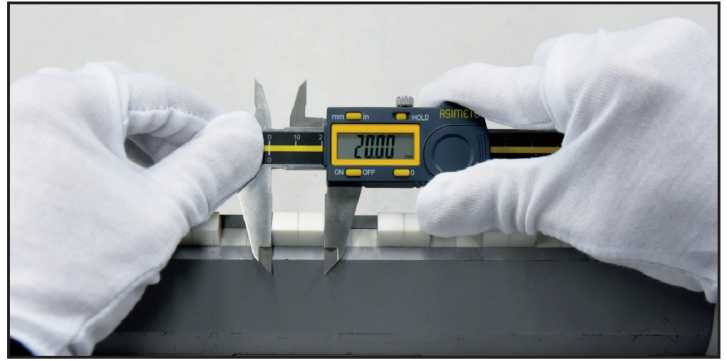

2 Ürün Açıklaması

Kalibrasyon Sertifikası

ASIMETO
Calibration Lab

Certificate No G30001
Part Number 307-06-0
Serial Number GS102042
Standard Name ASME B89.1.14
Tool 0-150mm/0-6"
Range 0.01mm/0.0005"
Resolution Digital Calipers

Function Inspection Passed Visual Inspection Passed

Outside Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
1	0.0000	±0.001"	0.0000	
2	1.0000"	±0.001"	-0.0010	
3	3.0000"	±0.001"	-0.0010	
4	4.5000"	±0.001"	-0.0015	
5	6.0000"	±0.001"	-0.0015	

Inside Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
6	0.2000"	±0.001"	0.0010	
7	1.0000"	±0.001"	0.0010	

Depth Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
8	0.0000	±0.001"	0.0000	

Master information

Depth set	258254	NIST-192837	Due Date
Gauge Block Set	258254	NIST-95837	2013-8-1
Setting Rings	258254	NIST-455837	2013-8-1

Uncertainty 6 µm +10⁻⁶×L Temperature 20 °C +/-0.5°C Humidity 50 % +/-15%

Attach invoice for proof of purchase date

* Check mark indicates within tolerance

Calibrator

Approved By

Asimeto (Guangzhou) Inc. Calibration Lab

402 Building B, Yushu Industrial Zone, Lufeng District, Guangzhou, China;

Tel: 020-82019119 Fax: 020-822261



1 Ölçüm Noktası
& Sonuç

3 Eğilim


4 Takip No.

Bilgi Çıkışlı Ölçü Aletleri

ABS Dijital Kumpas



Derinlik Kumpası



Dijital Mikrometre



Dijital Komparatör Saati



Sanal klavye verileri
toplar ve doğrudan
standart Microsoft
yazılımlarına iletir.
(Excel, Access)



Ölçüm Raporu

	A	B	C	D	E
1		A1	A2	A3	
2	1	10.02	15.53	20.44	
3	2	10.04	15.53	20.46	
4	3	10.01	15.52	20.44	
5	4	10.01	15.53	20.45	
6	5	10.02	15.54	20.46	
7					
8					
9	Average	10.02	15.53	20.45	

BİLGİ ÇIKIŞ KABLOLARI 900 SERİSİ

	UYGUN OLDUĞU ÜRÜN	GİRİŞ TİPİ	FORMAT	UYGUN OLDUĞU ÜRÜN	KOD NO.
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	USB	Dot Data Format	307-XX-2 ; 307-XX-3 105-XX-4 ; 105-XX-5 315-XX-6 ; 315-XX-8	900-05-4
			Comma Data Format		900-05-5
	IP65 Dijital Komparatör Saati	USB	Dot Data Format	407-XX-2 ; 407-XX-3 407-XX-4 ; 407-XX-5	900-07-0
			Comma Data Format		900-07-1
	Dijital Komparatör Saati	USB	Dot Data Format	405-95-X ; 405-01-X 405-02-X ; 405-04-X	900-20-0
	Dijital Mikrometre	USB	Dot Data Format	Özel Dijital Mikrometre	900-10-0
	Dijital Mikrometre	USB	Dot Data Format	Özel Dijital Mikrometre	900-10-2
	Wireless Tip için Ayak Kontrol Butonu				900-90-1

KABLOSUZ BİLGİ ÇIKIŞ TİPLERİ 901 SERİSİ

	KULLANILDIĞI ÜRÜN TİPİ	FONKSİYON	FREKANS	KOD NO.
	IP65 Dijital Komparatör Saati	Transmitter	2.4G	901-00-2
	IP65 Dijital Komparatör Saati ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Receiver	2.4G	901-00-3
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Transmitter	2.4G	901-00-4
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Transmitter with Footswitch Interface	2.4G	901-00-6
	IP65 Dijital Komparatör Saati	Transmitter with Footswitch Interface	2.4G	901-00-7

