

DİJİTAL YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM CİHAZI

ÖZELLİKLER

- 3,5 İNÇ RENKLİ GRAFİK DOKUNMATİK EKRAN, YÜKSEK PARLAKLIK VE GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI SAĞLAR
- TÜM BİLGİLERİ, SEZGİSEL VE GRAFİKSEL TÜM PARAMETRELERİ GÖRÜNTÜLER
- DSP ÇİP KONTROLÜ VE VERİ İŞLEME, YÜKSEK HIZ, DÜŞÜK GÜÇ TÜKETİMİ
- 4 PROFİL FİLTRESİ : GAUSS RC PC-RC D-P.
- ÇOKLU PARAMETRELER : RA, RZ, RQ, RT, RP, RV, R3Z, R3Y, RZ (JIS), RS, RSK, RSM, RKU, RC, RY, RMAX, RMR, RPC, RK, RPKv RVK, MR1v MR2.
- ISO, DIN, ANSI, JIS STANDARTLARINA UYGUNDUR
- BLUETOOTH YAZICI VE MOBİL APP KABLOSUZ ÇALIŞMASINI DESTEKLER
- BÜYÜK KAPASİTELİ VERİ DEPOLAMA, 100 ÖĞE HAM VERİ VE ÖLÇÜLEN PROFİLİ DEPOLAYABİLİR
- OTOMATİK UYKU, OTOMATİK KAPANMA GÜÇ TASARRUFU
- BİLGİSAYARA VE YAZICIYA BAĞLANABİLİR
- İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR ARASINDA KAVISLİ YÜZEY SENSÖRÜ, DERİN KANAL SENSÖRÜ, KÜÇÜK DELİK SENSÖRÜ, ÖLÇÜM STANDI, SENSÖR KILIFI, YAZICI VE ANALİZ YAZILIMI BULUNUR



KOD	İÇERİK	ÖZELLİKLER
AS-645130	ÖLÇÜM ARALIĞI	X Eksen : 17.5 mm / 0.69"
	ÖRNEKLEME UZUNLUĞU	Z Eksen : 320µm (-160µm ~ 160µm) / 12600µin (-6300µin ~ +6300µin)
	ÖLÇME HIZI	0.25, 0.8, 2.5 mm
	ÖLÇME KUVVETİ	0.135, 0.5, 1 mm/s, 1 mm/s (Dönüş)
	KALEM UCU	4mN
	BOYUT	Elmas, 90° / 5µmR tip radius
	GÜÇ KAYNAĞI	Kontrol Ünitesi : 160x64x53 mm Sürücü Ünitesi : 115x23x27 mm
	GÜÇ KAYNAĞI	3200mAh Şarj Edilebilir Lithium Batarya; AC Adaptör

ASIMETO KALİBRASYON LABORATUARI

Tüm ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin kalite ve kalibrasyon doğruluğu ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında hassas incelemelerle yapılmaktadır.

İncelemeler sırasında tüm hassas ölçü aletlerinin ASIMETO tarafından oluşturulan dizayn ve Dünya çapında standartlarla belirlenen toleranslara uygunluğu %100 olarak kontrol edilir.



Yalnızca Dünya'nın önde gelen firmaları tarafından üretilen son teknoloji kalibrasyon ekipmanları kullanılarak ASIMETO Hassas Ölçü Aletlerinin ölçüm hassasiyeti garanti altına alınır.

ASIMETO Kalibrasyon Laboratuvarındaki kalibrasyon ekipmanları hedef marketin ihtiyacına göre DIN, ASME, JJG gibi Uluslararası normların tamamına uyum gösterecek yazılımlarla donatılmıştır.

Tüm bu sayılanlara ASIMETO kalibrasyon laboratuvarında çalışanların uzmanlık, özveri ve çalışkanlıkları da eklendiğinde ihtiyacınızı karşılayacak hassasiyetteki ölçü aletine ödediğiniz her kuruşun karşılığını tamı tamına alacak şekilde sahip olduğunuza emin olabilirsiniz.

ASIMETO

Calibration Lab

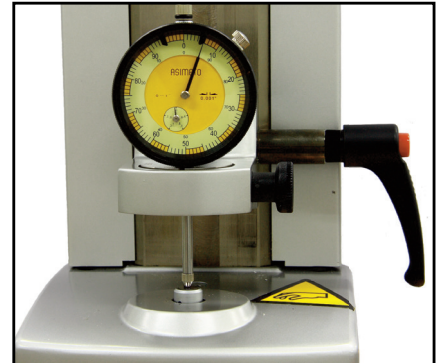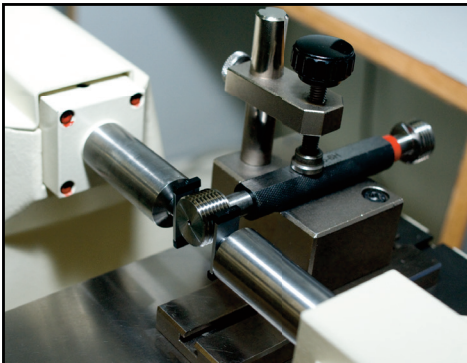

2 Ürün Açıklaması

Kalibrasyon Sertifikası

ASIMETO
Calibration Lab

Certificate No G30001
Part Number 307-06-0
Serial Number GS102042
Standard Name ASME B89.1.14
Tool 0-150mm/0-6"
Range 0.01mm/0.0005"
Resolution Digital Calipers

Function Inspection Passed Visual Inspection Passed

Outside Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
1	0.0000	±0.001"	0.0000	
2	1.0000"	±0.001"	-0.0010	
3	3.0000"	±0.001"	-0.0010	
4	4.5000"	±0.001"	-0.0015	
5	6.0000"	±0.001"	-0.0015	

Inside Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
6	0.2000"	±0.001"	0.0010	
7	1.0000"	±0.001"	0.0010	

Depth Measurements

Reading	Nominal Value	Tolerance +/-	Deviation	Disposition*
8	0.0000	±0.001"	0.0000	

Master information

Depth set	258254	NIST-192837	Due Date
Gauge Block Set	258254	NIST-95837	2013-8-1
Setting Rings	258254	NIST-455837	2013-8-1

Uncertainty 6 µm +10⁻⁶×L Temperature 20 °C +/-0.5°C Humidity 50 % +/-15%

Attach invoice for proof of purchase date

* Check mark indicates within tolerance

Calibrator

Approved By

Asimeto (Guangzhou) Inc. Calibration Lab

402 Building B, Yushu Industrial Zone, Lufeng District, Guangzhou, China;

Tel: 020-82019119 Fax: 020-822261




1 Ölçüm Noktası
& Sonuç

3 Eğilim


4 Takip No.

Bilgi Çıkışlı Ölçü Aletleri

ABS Dijital Kumpas

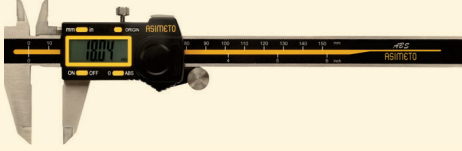

Derinlik Kumpası

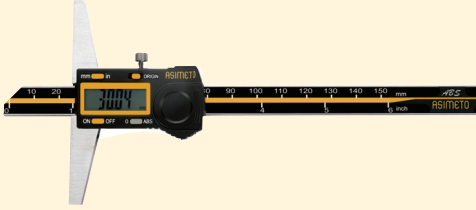

Dijital Mikrometre



Dijital Komparatör Saati



Sanal klavye verileri
toplar ve doğrudan
standart Microsoft
yazılımlarına iletir.
(Excel, Access)



Ölçüm Raporu

	A	B	C	D	E
1		A1	A2	A3	
2	1	10.02	15.53	20.44	
3	2	10.04	15.53	20.46	
4	3	10.01	15.52	20.44	
5	4	10.01	15.53	20.45	
6	5	10.02	15.54	20.46	
7					
8					
9	Average	10.02	15.53	20.45	

BİLGİ ÇIKIŞ KABLOLARI 900 SERİSİ

	UYGUN OLDUĞU ÜRÜN	GİRİŞ TİPİ	FORMAT	UYGUN OLDUĞU ÜRÜN	KOD NO.
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	USB	Dot Data Format	307-XX-2 ; 307-XX-3 105-XX-4 ; 105-XX-5 315-XX-6 ; 315-XX-8	900-05-4
			Comma Data Format		900-05-5
	IP65 Dijital Komparatör Saati	USB	Dot Data Format	407-XX-2 ; 407-XX-3 407-XX-4 ; 407-XX-5	900-07-0
			Comma Data Format		900-07-1
	Dijital Komparatör Saati	USB	Dot Data Format	405-95-X ; 405-01-X 405-02-X ; 405-04-X	900-20-0
	Dijital Mikrometre	USB	Dot Data Format	Özel Dijital Mikrometre	900-10-0
	Dijital Mikrometre	USB	Dot Data Format	Özel Dijital Mikrometre	900-10-2
	Wireless Tip İçin Ayak Kontrol Butonu				900-90-1

KABLOSUZ BİLGİ ÇIKIŞ TİPLERİ 901 SERİSİ

	KULLANILDIĞI ÜRÜN TİPİ	FONKSİYON	FREKANS	KOD NO.
	IP65 Dijital Komparatör Saati	Transmitter	2.4G	901-00-2
	IP65 Dijital Komparatör Saati ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Receiver	2.4G	901-00-3
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Transmitter	2.4G	901-00-4
	ABS Dijital Kumpas Dijital Mikrometre Ağır İş Dijital Kumpas	Transmitter with Footswitch Interface	2.4G	901-00-6
	IP65 Dijital Komparatör Saati	Transmitter with Footswitch Interface	2.4G	901-00-7

